

# SARS-CoV-2 Antigen-Testkit (LFIA)

Selbsttest

**NUR FÜR IN-VITRO-DIAGNOSTISCHE ZWECKE.  
FÜR SELBSTTESTS.  
BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG  
BEVOR SIE DEN TEST DURCHFÜHREN.**

**Testkassette: 1 St. / Tasche**

REF	Spezifizierung
1031-14-01	1 St. / Box
1031-34-01	5 St. / Box
1031-54-01	20 St. / Box

Anzeige des  
anterioren  
Nasenabstrichs in  
Originalgröße

## Inhalt des Kits




Testkassette  
(einzeln im Folienbeutel  
mit Trocknungsmittel)



Lysepuffer  
und Tropfer



Anterioren  
Nasenabstrich  
(CE 0197)





Gebrauchsanweisung



Bio-Sicherheitsbeutel

## Vorbereitung


1. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände
2. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig
3. Kontrollieren Sie das Verfallsdatum auf dem Folienbeutel

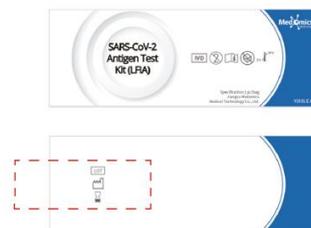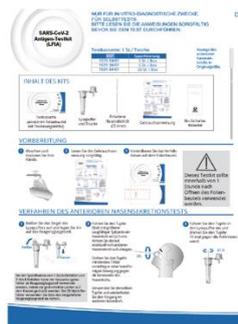

Dieses Testkit sollte  
innerhalb von 1  
Stunde nach  
Öffnen des  
Folienbeutels  
verwendet werden.


## Verfahren des anterioren Nasensekretionstests

1. Reißen Sie das Siegel des Lysepuffers auf und legen Sie ihn auf das Reagenzglasgestell.

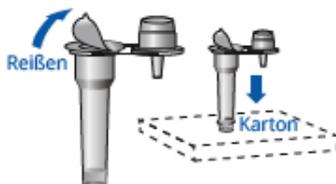


Bei der Spezifikation von 1 Stück/Behälter und 5 Stück/Behälter kann der Verpackungsbehälter als Reagenzglasgestell verwendet werden, indem die gestrichelten Löcher auf dem Kasten gedrückt werden. Bei 20 Stück/Behälter verwenden Sie bitte das mitgelieferte Reagenzglasgestell im Karton.


- Führen Sie den Tupfer (Stab mit größerer saugfähiger Spitze) in ein Nasenloch ein (2,5 cm). Achten Sie darauf, eventuell vorhandenen Nasensekret aufzufangen. Drehen Sie den Tupfer mindestens 5 Mal vorsichtig in einer kreisförmigen Bewegung gegen die Innenseite des Nasenlochs. Verwenden Sie denselben Tupfer und wiederholen Sie den Vorgang im anderen Nasenloch.

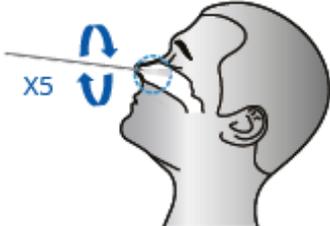

- Führen Sie den Tupfer in den Lysepuffer ein und drehen Sie den Tupfer 10-mal gegen die Rohrrinnenwand.




- Drücken Sie den Tupfer 5 Mal von der äußeren Röhrenwand ab. Heben Sie den Tupfer über die Pufferlösung, drücken Sie den Tupfer einmal von der äußeren Röhrenwand ab, um die Probe so weit wie möglich im Röhren zu belassen.

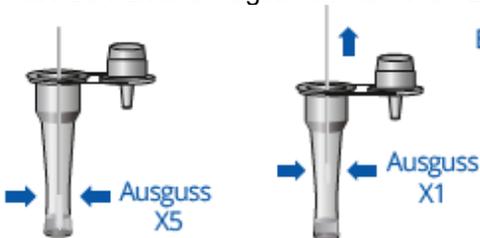

- Brechen Sie den Tupfer ab und bedecken Sie das Röhren mit dem Tropfer.



- Geben Sie 4 Tropfen verarbeiteten Probenextrakt in die Probenvertiefung.




Öffnen Sie den Folienbeutel und legen Sie die Testkassette auf eine saubere, flache Oberfläche

7. Lesen Sie die Ergebnisse innerhalb von 15-20 Minuten ab. Bemerkung: Zusätzlich erforderliche, aber nicht mitgelieferte Ausrüstung: Zeitschaltuhr Entsorgen Sie alle verwendeten Materialien in einem Bio-Sicherheitsbeutel und verschließen Sie diesen gut.



Nach 20 Minuten abgelesene Ergebnisse sind ungültig.

## Anzeige des Ergebnisses / der erwarteten Werte

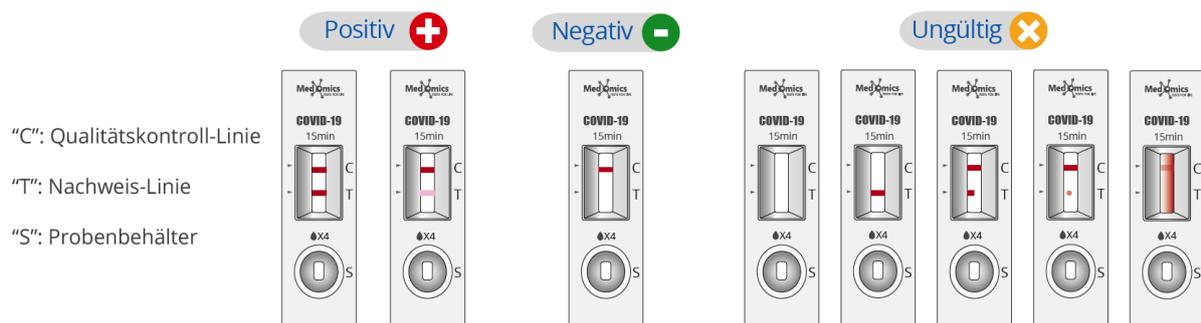

- Positives Ergebnis: Wenn sowohl die Qualitätskontroll-C-Linie als auch die Nachweis-T-Linie erscheinen, wurden die SARS-CoV-2-Antigene nachgewiesen und das Ergebnis ist positiv.
- Negatives Ergebnis: Wenn nur die Qualitätskontroll-C-Linie erscheint und die Nachweis-T-Linie nicht sichtbar ist, enthält die Probe keine SARS-CoV-2-Antigene oder die SARS-CoV-2-Antigenkonzentration liegt unter der Nachweisgrenze und das Ergebnis ist negativ.
- Ungültiges Ergebnis: Wenn die C-Linie nicht erscheint, die T-Linie nicht vollständig ist oder ein rötlich-violetter Hintergrund die Interpretation beeinträchtigt, ist das Ergebnis ungültig und ein neuer Test muss durchgeführt werden.

**Hinweis:** Die Farbintensität der T-Linie steht im Zusammenhang mit der Konzentration der in der Probe enthaltenen SARS-CoV-2-Antigene. Das Ergebnis sollte unabhängig von der Farbintensität danach bestimmt werden, ob die T-Linie gefärbt ist oder nicht.

## Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

### Wenn das Testergebnis positiv ist:

- Es besteht der Verdacht auf eine COVID-19-Infektion
- Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt / Hausarzt oder an das örtliche Gesundheitsamt
- Halten Sie sich an die örtlichen Richtlinien zur Selbstisolierung
- Führen Sie zur Bestätigung einen PCR-Test durch

### Wenn das Testergebnis negativ ist:

- Halten Sie weiterhin alle geltenden Vorschriften für den Kontakt mit anderen Personen und Schutzmaßnahmen ein
- Es kann eine Infektion vorliegen, selbst wenn der Test negativ ausfallen sollte.
- Bei Verdacht ist der Test nach 1 - 2 Tagen zu wiederholen, da das Coronavirus nicht in allen Phasen der Infektion genau nachgewiesen werden kann

### Wenn das Testergebnis ungültig ist:

- Möglicherweise durch fehlerhafte Testdurchführung verursacht
- Wiederholen Sie den Test
- Bleibt das Testergebnis ungültig, wenden Sie sich an den Arzt oder das COVID-19-Testzentrum

**Dieses Testkit ist nur für Selbsttests bestimmt.**

**Dieser Testkit ist nur für die In-vitro-Diagnose bestimmt.**

**Dieses Testkit ist nur für Personen ab 18 Jahren bestimmt.**

**Bringen Sie den Inhalt des Kits vor dem Test auf Raumtemperatur.**

**Ein negatives Ergebnis schließt eine SARS-CoV-2-Infektion nicht aus, insbesondere bei Personen, die Kontakt zu Patienten hatten.**

**Nicht wiederverwenden.**

**Verwenden Sie das Testkit nicht, wenn der Beutel beschädigt, das Siegel gebrochen oder die Testkassette nass oder verschmutzt ist. Verwenden Sie den Inhalt des Testkits nicht, wenn er abgelaufen ist.**

**Verwenden Sie für die Entnahme einer anterioren Nasenabstrichprobe nur den im Kit enthaltenen anterioren Nasenabstrich.**



Bitte treffen Sie KEINE Entscheidung von medizinischer Relevanz ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt/Allgemeinmediziner.



Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

## Einführung

Das Coronavirus (CoV) gehört zur Ordnung Nidovirales unter der Familie der Coronaviridae mit 4 Gattungen:  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  und  $\delta$ . Die Gattungen  $\alpha$  und  $\beta$  sind nur für Säugetiere pathogen, während die Gattungen  $\gamma$  und  $\delta$  hauptsächlich Vogelinfektionen verursachen. CoV wird hauptsächlich durch direkten Kontakt mit Sekreten oder durch Aerosole und Tröpfchen übertragen. Es gibt auch Hinweise darauf, die eine fäkal-orale Übertragung vermuten lassen. Bislang wurden 7 Arten von humanen Coronaviren (HCoV), die menschliche Atemwegserkrankungen verursachen, identifiziert: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV und SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ist einer der ansteckendsten viralen Erreger, die beim Menschen Atemwegsinfektionen (RTI) verursachen. Derzeit sind die mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Patienten die Hauptinfektionsquelle, aber auch asymptomatisch infizierte Personen können eine Infektionsquelle sein. Basierend auf den aktuellen epidemiologischen Untersuchungen beträgt die Inkubationszeit 1 bis 14 Tage, meist 3 bis 7 Tage. Die klinischen Manifestationen umfassen Fieber, Müdigkeit, Husten und andere Symptome, begleitet von Dyspnoe, die sich schnell zu einer lebensbedrohlichen schweren Lungenentzündung, einem respiratorischen Versagen, einem akuten respiratorischen Bläschensyndrom, einem septischen Schock, multiplen Organversagen und einem schweren metabolischen Säure-Basen-Ungleichgewicht entwickeln kann.

## Verwendungszweck

Das SARS-CoV-2-Antigen-Testkit (LFIA) ist ein kolloidales Gold-Immuno-chromatographie-Verfahren für den schnellen qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Antigenen in menschlichen anterioren Nasenproben in vitro. Das Testkit ist für die Verwendung als Selbsttest konzipiert. Dieses Testkit ist für Personen ab 18 Jahren bestimmt, die klinische Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion aufweisen oder bei denen ein Verdacht auf COVID-19 besteht. Wenn die verdächtige Person respiratorische Symptome aufweist oder der Verdacht auf eine Infektion besteht, wird empfohlen, einen PCR-Test, klinische Symptome, Prävalenz und weitere klinische Daten zu kombinieren, um die Diagnose abzusichern.

## Testprinzip

Das SARS-CoV-2-Antigen-Testkit (LFIA) weist die SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Antigene mittels kolloidaler Gold-Immuno-chromatographie unter Verwendung eines Doppelantikörper-Sandwich-Tests nach. Die Testkassette enthält (1) einen mit kolloidalem Gold markierten Anti-SARS-CoV-2-Nukleokapsidprotein-Antikörper, (2) eine T-Linie zum Nachweis und eine C-Linie zur Qualitätskontrolle, die auf einer Nitrocellulosemembran fixiert sind. Die T-Linie wird mit einem anderen Anti-SARS-CoV-2-Nukleokapsidprotein-Antikörper zum Nachweis von SARS-CoV-2 fixiert. Der Qualitätskontroll-Antikörper wird auf der C-Linie fixiert. Wenn die entsprechende Menge der mit Lysepuffer behandelten Probe in die Probenvertiefung der Testkassette gegeben wird, bewegt sich die Probe durch Kapillarwirkung auf dem Teststreifen vorwärts.

Falls die Probe SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Antigene enthält und die Konzentration über der Nachweisgrenze liegt, binden die Antigene an den mit kolloidalem Gold markierten Anti-SARS-CoV-2-Nukleokapsidprotein-Antikörper. Der Immunkomplex wird von einem anderen Anti-SARS-CoV-2-Nuk-

leokapsidprotein-Antikörper, der auf der Membran immobilisiert ist, eingefangen und bildet eine rote T-Linie, die ein positives Ergebnis für SARS-CoV-2 anzeigt. Sollte die Probe keine SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Antigene enthalten oder die Konzentration unter der Nachweisgrenze liegen, wird ein negatives Ergebnis angezeigt.

## Interne Qualitätskontrolle

Die Testkassette enthält eine C-Linie zur Qualitätskontrolle. Unabhängig davon, welche Nukleokapsid-Antigene vorhanden sind, sollte die C-Linie erscheinen, um anzuzeigen, dass die Probe ordnungsgemäß durch die Membran transportiert wurde. Sollte die C-Linie nicht erscheinen, bedeutet dies, dass das Testergebnis ungültig ist und die Probe erneut getestet werden muss.

## Virusmutation-Nachweiskompatibilität-Tipps

Das SARS-CoV-2-Antigen-Testkit (LFIA) weist das Nukleokapsidprotein, NICHT das Spike-Protein von SARS-CoV-2 nach. Die Mutationen der SARS-CoV-2-Varianten B.1.1.7/B.1.351/P.1/B.1.617.1/B.1.617.2/ B.1.1.529/B.1.526/B.1.427/B.1.429 sollten bestätigt werden. Und all diese Varianten von Nukleokapsidproteinen können mit dem SARS-CoV-2-Antigen-Testkit (LFIA) effektiv nachgewiesen werden.

## Inhalt des Kits

Spezifizierung	Testkassette	Anteriorer Nasenabstrich	Lysepuffe und Tropfer	Bio-Sicherheitsbeutel	Gebrauchsanweisung	Reagenzglasgestell
1 St. /Box	1	1	1	1	1	Bitte verwenden Sie die Verpackungsbox
5 St. /Box	5	5	5	5	1	Bitte verwenden Sie die Verpackungsbox
20 St. /Box	20	20	20	20	1	1

Testkassette enthält Teststreifen, Kunststoffkassette, Trocknungsmittel. Der Teststreifen enthält einen mit kolloidalem Gold markierten Anti-SARS-CoV-2-Nukleokapsidprotein-Antikörper, eine Nitrozellulosemembran (C-Linie fixiert mit Ziege-anti-Maus IgG-polyklonalem Antikörper und T-Linie fixiert mit einem anderen anti-SARS-CoV-2 Nukleokapsid-Protein Antikörper).

## Entsorgungshinweise

Legen Sie alle verwendeten Komponenten zurück in den Bio-Sicherheitsbeutel. Beachten Sie bei der Entsorgung die geltenden Vorschriften.

## Anweisung zur Lagerung

Das Testkit sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei 2 bis 30 Grad Celsius gelagert werden, wobei die Haltbarkeit auf der Primärverpackung angegeben ist. Dieses Testkit sollte innerhalb von 1 Stunde nach Öffnen des Folienbeutels verwendet werden.

## Einschränkungen für die Testmethode

- Die Genauigkeit des Tests ist abhängig von der Qualität der Probe. Unsachgemäße Probenahme oder Lagerung, die Verwendung abgelaufener Proben oder wiederholt eingefrorene und aufgetaute Proben können das Testergebnis beeinflussen. Die Testergebnisse können auch durch Temperatur und Feuchtigkeit beeinflusst werden.
- Negative Ergebnisse können an einer niedrigen Konzentration von SARS-CoV-2-Antigene in der Probe liegen, weshalb eine Infektion nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.
- Einige Medikamente (z. B. hohe Konzentration von rezeptfreien oder verschreibungspflichtigen Medikamenten wie Nasenspray) in den gesammelten Proben können das Testergebnis

beeinträchtigen. Bitte führen Sie den Test erneut durch, falls das Ergebnis zweifelhaft ist.

- Dieses Produkt ist nur für qualitative Tests geeignet. Die spezifische Konzentration der einzelnen Indikatoren muss mit anderen quantitativen Methoden gemessen werden.
- Für den Nachweis neuartiger Coronaviren und möglicher Subtypen (mutierte Stämme) können die durch Mutationsstellen des Nukleokapsidproteins verursachten Epitopveränderungen die analytische Empfindlichkeit des Reagenzes verringern und zu falsch negativen Ergebnissen führen.

## Produktleistung

- In Studien zur Nachweisgrenze (Limit of Detection, LoD) wurde die niedrigste nachweisbare Konzentration von SARS-CoV-2 bestimmt, bei der  $\geq 95$  % aller (echt positiven) Replikate positiv testen. Zu diesem Zweck wurde der SARS-CoV-2-Wildtyp mit Lysepuffer auf einen finalen Konzentrationsgradienten von 5, 10, 50, 100, 200, 1000 TCID<sub>50</sub>/mL verdünnt. Die LOD: 10 TCID<sub>50</sub>/mL.

SARS-CoV-2 Wildtyp getestet (TCID <sub>50</sub> /mL)	Testergebnis
1000	20/20 positiv
200	20/20 positiv
100	20/20 positiv
50	20/20 positiv
10	20/20 positiv
5	12/20 positiv

- Verifizierung von Varianten

Das SARS-CoV-2-Antigen-Testkit (LFIA) kann die rekombinanten Nukleokapsid-Antigene der unten aufgeführten SARS-CoV-2-Varianten nachweisen.

WHO Label	Alpha	Beta	Gamma	Kappa	Delta	Omicron	Iota	Epsilon
Pango lineage	B.1.1.7	B.1.351	P.1	B.1.617.1	B.1.617.2	B.1.1.529	B.1.526	B.1.427/B.1.429

- Kreuzreaktivität

Die Kreuzreaktivität und potenzielle Interferenz des SARS-CoV-2-Antigen-Testkits (LFIA) wurden durch Testen von kommensalen und pathogenen Mikroorganismen, die mit Nasenabstrichen als Probenmatrix verdünnt wurden, in Abwesenheit oder Anwesenheit von hitzeinaktiviertem SARS-CoV-2-Virus bewertet. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Elemente können in den klinischen Proben vorhanden sein. Jedes Bakterium, jeder Virus und jede Hefe wurde in dreifacher Ausfertigung getestet, wobei es keine falsch positiven Ergebnisse gab.

Potenzielles Kreuzreaktionsmittel	Geprüfte Konzentration	Kreuzreaktivität (Ja/Nein)
Menschliches coronavirus 229E	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
Menschliches coronavirus OC43	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
Menschliches coronavirus NL63	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
Menschliches coronavirus HKU1	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
MERS-coronavirus	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
SARS-coronavirus	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
Influenza A H1N1	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
Influenza A H3N2	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
Influenza A H5N1	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
Influenza A H7N9	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
Influenza B Victoria	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
Influenza B Yamagata	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
Parainfluenza virus Typ 1	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
Respiratorisches Synzytial-Virus	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
Enterovirus CA16e	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
Adenovirus	1.0 x 10 <sup>5</sup> TCID <sub>50</sub> /ml	Nein
Mycoplasma pneumoniae	1.0 x 10 <sup>6</sup> CFU/ml	Nein
Staphylococcus aureus	1.0 x 10 <sup>6</sup> CFU/ml	Nein
Staphylococcus epidermidis	1.0 x 10 <sup>6</sup> CFU/ml	Nein
Bordetella pertussis	1.0 x 10 <sup>6</sup> CFU/ml	Nein
Legionella pneumophila	1.0 x 10 <sup>6</sup> CFU/ml	Nein
Streptococcus pneumoniae	1.0 x 10 <sup>6</sup> CFU/ml	Nein
Hämophilus influenzae	1.0 x 10 <sup>6</sup> CFU/ml	Nein
Mycobacterium tuberculosis	1.0 x 10 <sup>6</sup> CFU/ml	Nein
Candida albicans	1.0 x 10 <sup>6</sup> CFU/ml	Nein

- Auswirkung von störenden Substanzen**  
 Es wurde eine Studie durchgeführt, um zu evaluieren und nachzuweisen, dass endogene Substanzen, die natürlicherweise vorhanden sind, oder Medikamente, die künstlich in klinische Proben eingebracht werden können, den Nachweis von SARS-CoV-2 im Medomics SARS-CoV-2-Antigen-Testkit (LFIA) bei den unten aufgeführten Konzentrationen nicht beeinträchtigen. Verdünnen Sie die getesteten Produkte mit einem Nasenabstrich als Probenmatrix in Abwesenheit oder Anwesenheit von hitzeinaktiviertem SARS-CoV-2 Virus.

Typ	Potenziell störende Substanzen	Konzentration	Interferenz (ja / Nein)
Endogener Stoff	Mucin	2% w/v	Nein
Endogener Stoff	Whole Blood	5% w/v	Nein
Endogener Stoff	Icteric (Bilirubin)	40 mg/dL	Nein
Endogener Stoff	Rheumatoid factor	200 IU/mL	Nein
Endogener Stoff	Triglycerides	1.5 mg/L	Nein
Endogener Stoff	Hemoglobin	100 mg/L	Nein
Endogener Stoff	Anti-nuclear antibody	>1:40	Nein
Endogener Stoff	Total IgG	90 g/L	Nein
Endogener Stoff	Total IgM	4 g/L	Nein
Endogener Stoff	Total IgA	80 g/L	Nein
Exogene Substanz	Mupirocin	0.25% w/v	Nein
Exogene Substanz	Tamiflu (Oseltamivir Phosphate)	0.5% w/v	Nein
Exogene Substanz	Fluticasone Propionate	5% w/v	Nein
Exogene Substanz	Fluconazole	5% w/v	Nein
Exogene Substanz	Zincum gluconium (i.e., Zicam)	5% w/v	Nein
Exogene Substanz	Alkalol	10% w/v	Nein
Exogene Substanz	Phenol	15% w/v	Nein
Exogene Substanz	Phenylephrine hydrochloride	15% v/v	Nein
Exogene Substanz	Oxymetazolin hydrochloride	15% v/v	Nein
Exogene Substanz	Cromolyn	15% w/v	Nein
Exogene Substanz	Oxymetazoline	15% w/v	Nein
Exogene Substanz	Galphimia glauca, Sabadilla	20% w/v	Nein
Exogene Substanz	Albuterol	0.005 mg/dL	Nein
Exogene Substanz	Acarbose	0.03 mg/dL	Nein
Exogene Substanz	Oseltamivir	0.04 mg/dL	Nein
Exogene Substanz	Chlorpheniramine	0.08 mg/dL	Nein
Exogene Substanz	Diphenhydramine	0.08 mg/dL	Nein
Exogene Substanz	Glimepiride (Sulfonylureas)	0.164 mg/dL	Nein
Exogene Substanz	Chlorothiazide	2.7 mg/dL	Nein
Exogene Substanz	Acetylsalicylic acid	3 mg/dL	Nein
Exogene Substanz	Amoxicillin	5.4 mg/dL	Nein
Exogene Substanz	Ibuprofen	21.9 mg/dL	Nein
Exogene Substanz	Beclomethasone	4.79 ng/mL	Nein
Exogene Substanz	Indapamide	140 ng/ml	Nein
Exogene Substanz	Flunisolide	0.61 µg/mL	Nein
Exogene Substanz	Guaiacol glyceryl ether	1 µg/mL	Nein
Exogene Substanz	Biotin	1.2 µg/mL	Nein
Exogene Substanz	Zanamivir	17.3 µg /mL	Nein
Exogene Substanz	Tobramycin	24.03 µg/mL	Nein
Exogene Substanz	Sulfur	9.23 µg/mL	Nein
Exogene Substanz	Ribavirin	26.7 µg /mL	Nein
Exogene Substanz	Ephedrine	0.1 mg/mL	Nein
Exogene Substanz	Benzocaine	0.13 mg/mL	Nein
Exogene Substanz	Menthol	0.15 mg/mL	Nein
Exogene Substanz	Budesonide	0.5 mg/mL	Nein
Exogene Substanz	Triamcinolone	0.8 mg/mL	Nein
Exogene Substanz	Dexamethasone	0.8 mg/mL	Nein
Exogene Substanz	Sodium chloride with preservatives	4.44 mg/mL	Nein
Exogene Substanz	Lopinavir	16.4 µg/L	Nein
Exogene Substanz	Ritonavir	16.4 µg/L	Nein
Exogene Substanz	Chloroquine phosphate	0.99 mg/L	Nein
Exogene Substanz	Ivermectin	4.4 mg/L	Nein

- Klinische Leistung

Die Leistung des SARS-CoV-2-Antigen-Testkits (LFIA) wurde mit 566 vorderen Nasenabstrichen und 566 Nasopharyngealabstrichen bewertet. Von denselben Personen wurden zwei Abstriche entnommen, ein vorderer Nasenabstrich, der direkt mit dem SARS-CoV-2-Antigen-Testkit (LFIA) getestet wurde, und ein Nasopharyngealabstrich, der mit dem EU-gekennzeichneten RT-PCR-Testkit getestet wurde. Positive Proben wurden von Patienten mit COVID-19-Symptomen innerhalb von 7 Tagen nach Auftreten der Symptome entnommen. Bei den in den klinischen Studien verwendeten Vergleichskits handelt es sich um das von Vitassay Healthcare S.L.U. hergestellte und in der EU zugelassene SARS-CoV-2-Testkit (Real-time PCR).

Medomics Ag Test	RT-PCR		
	Positiv	Negativ	Gesamt
Positiv	101	0	101
Negativ	9	456	465
Gesamt	110	456	566
<b>*95% Konfidenzintervall</b>			
*95% Konfidenzintervall	PPV: 100%(96. 41%~100.00%)		
Sensitivität: 91.82%(85.04%~96. 19%)	NPV: 98.06%(96. 36%~99.11%)		
Spezifität: 100%(99. 19%~ 100.00%)	Genauigkeit: 98.41%(97.00%~99. 27%)		

[Literaturhinweise]

- 1 | LY Wang, PR Chen, G W Zheng, et al. Research progress on novel coronavirus test methods. *Modern Medicine and Clinic*, 2020, 35(3): 411-416.
- 2 | K Tugba, W Ralph, L Hakho. Molecular and Immunological Diagnostic Tests of COVID-19: Current Status and Challenges. *IScience*, 2020, 23 (8): Doi: 10.1016/j.isci.2020.101406